MODE D'EMPLOI MINI MICROSCOPE ELECTRONIQUE ZOOM X800 USB PORTABLE 8 LED 2 MP

REF. : Y-mmd3







Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI MINI MICROSCOPE ELECTRONIQUE ZOOM X800 USB PORTABLE 8 LED 2 MP

REF. : Y-mmd3

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE 2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION 3

PRÉSENTATION DE VOTRE MICROSCOPE



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Première utilisation de votre microscope USB

Pour utiliser votre microscope, il vous suffit de vous munir d'un ordinateur, fonctionnant sous Windows (Toutes versions) ou Mac (Toutes versions) et disposant d'un port USB libre.

Un cd-rom peut être présent avec le produit. Merci de ne pas l'utiliser. Nous vous conseillons de télécharger les pilotes en cliquant directement ce lien ou en recopiant cette adresse dans un navigateur internet :

http://dl.free.fr/ww5pCPUXo


Une fois le fichier ZIP télécharger, il vous suffit de dézipper ce fichier et d'ouvrir le dossier une fois la tache effectuée. Vous aurez un premier dossier, entrez dans ce dossier et vous devez retrouver le contenu suivant :



Si votre ordinateur fonctionne sous Windows, il vous suffit de double cliquer sur le programme « DrvSetup.exe » et de procéder à l'installation des drivers.


Si votre ordinateur est un Mac et tourne donc sous une version Mac OS, il vous suffit de vous rendre dans le dossier « mac » jusqu'à trouver un fichier DOS nommé : MicroCapture qui sera le logiciel nécessaire au fonctionnement de votre microscope.

Ensuite, connectez simplement votre microscope à votre ordinateur par USB. Une installation de pilote peut se lancer automatiquement. Une fois les pilotes installés, cliquez une fois sur le bouton rouge situé sur le microscope.

Une interface s'ouvre et l'icône suivant apparait dans votre barre de tâches : . Le logiciel de votre microscope est maintenant activé.

II - Utilisation du logiciel de votre microscope

Vous devez avoir la fenêtre suivante devant les yeux :

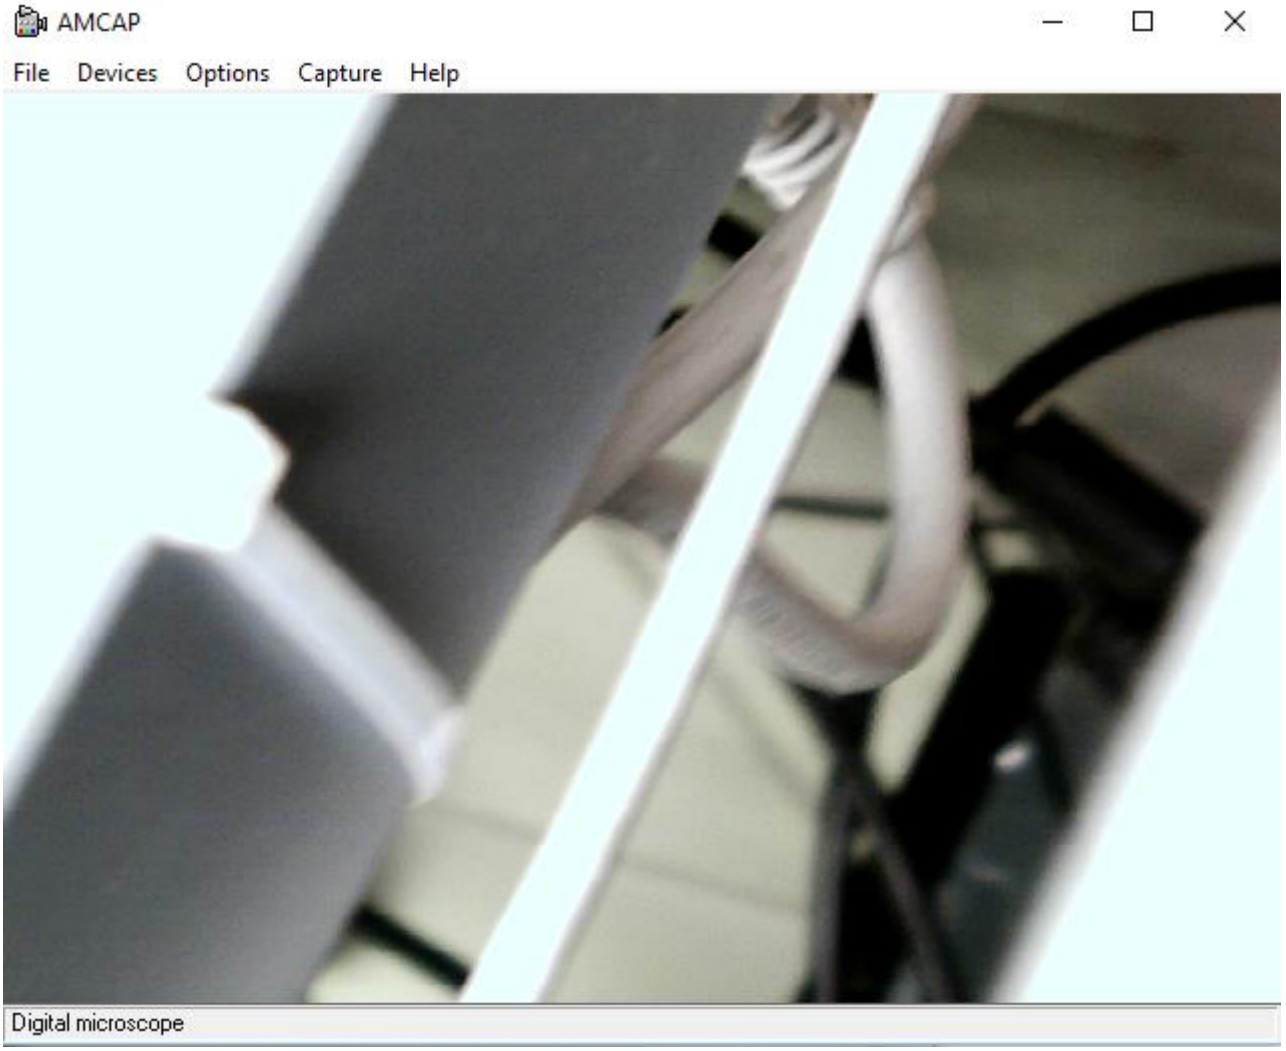

Nous allons reprendre les différents menus qui apparaissent sur l'interface.

File :

- Set capture file : permet de sélectionner le dossier par défaut pour l'enregistrement des captures. En cliquant dessus, une fenêtre va s'ouvrir. Il vous suffit de sélectionner le dossier que vous souhaitez enregistrer comme dossier de destination des photos et vidéos.

- Exit : vous permet de fermer le programme.

Devices :

Cela permet de sélectionner le microscope que vous souhaitez utiliser pour la capture (vous pouvez en utiliser plusieurs sur le même ordinateur).

Options :


- Preview : permet d'afficher l'image en temps réel dans la fenêtre (celle-ci est cochée par défaut). - Audio format : ce mode n'est pas disponible pour votre produit, celui-ci n'étant pas équipé d'un micro.

- Video capture filter : vous permet d'appliquer certains filtres sur vos images. Nous vous conseillons de les sélectionner et de voir les rendus en direct sur l'image. Plusieurs autres options apparaissent dans cet onglet comme le réglage de la luminosité, le contraste. Comme précédemment, nous vous invitons à modifier ces réglages en vérifiant le rendu en direct.

- Video capture pin : vous permet d'effectuer les réglages pour la résolution de l'image.

Capture :

- Start capture : vous permet de lancer un enregistrement vidéo. Une fenêtre apparait vous demandant si vous êtes prêt pour l'enregistrement ainsi qu'avec le chemin de destination du fichier.

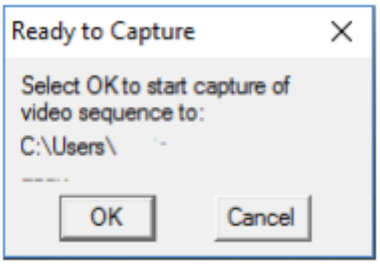

Cliquez sur « ok » pour le lancer.

- Stop Capture : Il vous suffit de retourner sur capture puis de cliquer sur « stop capture » pour arrêter l'enregistrement.

- Set frame rate : cette option permet de régler le nombre d'images par seconde.

- Set time limit : permet de régler le temps d'enregistrement, en secondes (cochez la case « use time limit » pour que cela fonctionne).

Le bouton rouge présent sur le microscope permet, en plus de lancer le logiciel, de faire des photos. Un simple clic dessus prendra un cliché.

Le bouton on/off vous permet d'allumer les LEDs présentent dans le microscope.