MODE D'EMPLOI

Y-MCB140



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Wewoo.fr.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.wewoo.fr

- Via le site de votre achat (Amazon, Cdiscount, Rueducommerce...Etc.)
- Par mail à contact@wewoo.fr
- Par téléphone au 0 806 110 225 (non surtaxé, prix d'un appel local) de 09h00 à 12h00 et 14h00 et 17h00


Mode d'emploi

Table des matières


Smartwatch 2
Verrouiller/déverrouiller l'écran 3
Passez un appel 3
Photo 4
Changement de fond d'écran 4
Personnes 5
Tests de fréquence cardiaque en charge 6

Smartwatch


SmartWatch

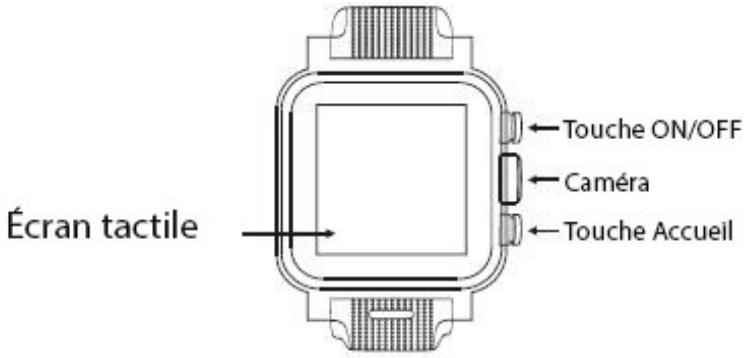

ASTUCE : Lorsque vous démarrez la montre, appuyez longuement sur la touche

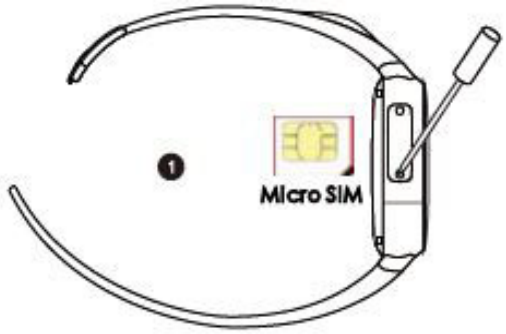

● Compatible avec une Micro SIM. Pour la mettre en place, utilisez un petit tournevis.

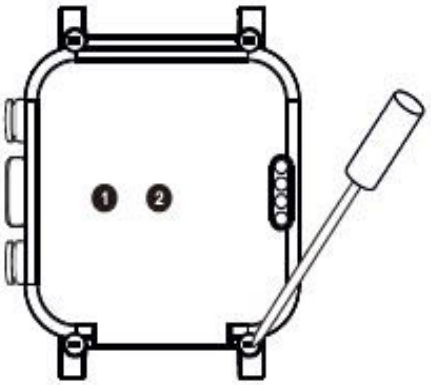

1. Insérer une pile
2. Insertion de la pile : la pile peut être insérée dans la carte T

Verrouiller/déverrouiller l'écran




Touchez l'écran pour le déverrouiller, appuyez sur le bouton d'alimentation pour le verrouiller

Passez un appel




Vous pouvez passer un appel directement sur le clavier virtuel, vous pouvez également rechercher la personne dans la liste des contacts.

Photo

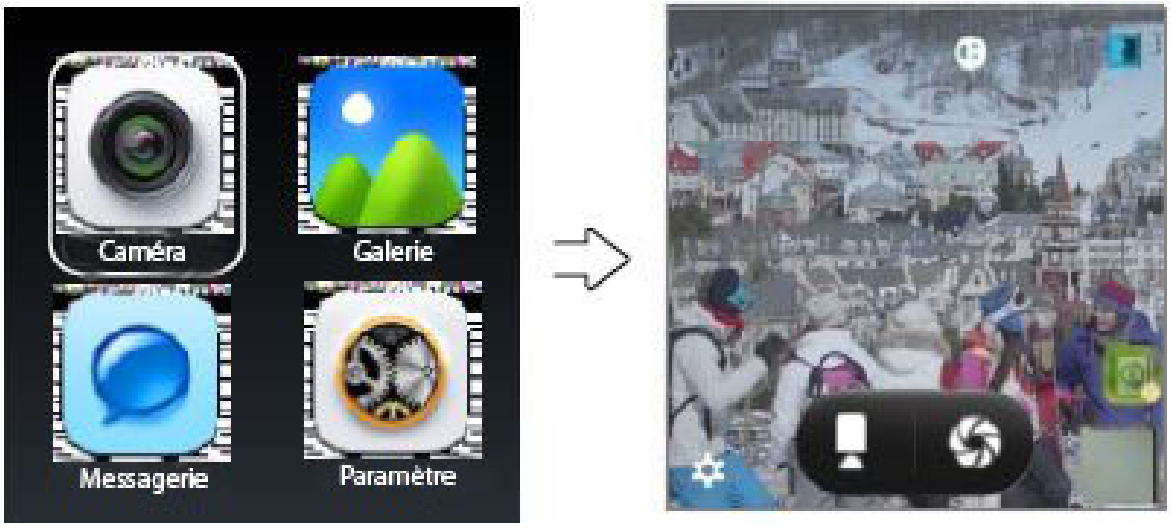


Ouvrez la caméra, la prise de vue continue est prise en charge, faites glisser la touche sur l'icône de la vidéo, et vous pouvez commencer l'enregistrement vidéo.

Changement de fond d'écran

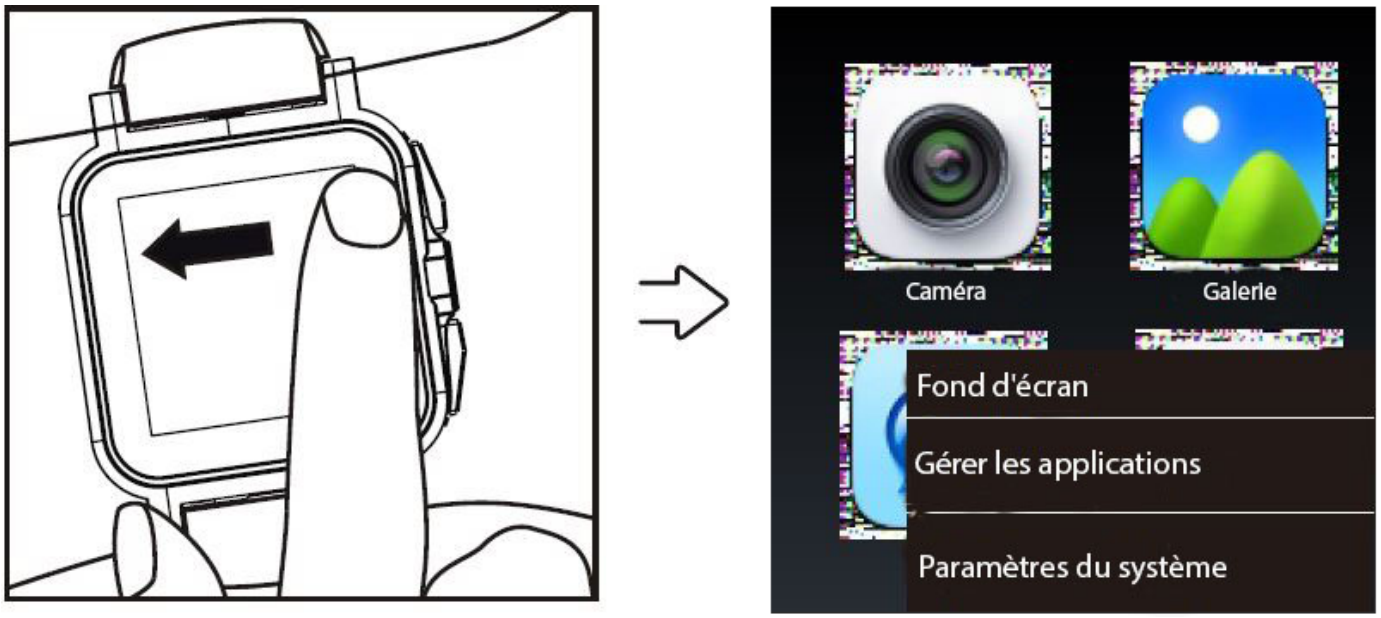

Appuyez longuement sur la zone vide de l'écran d'accueil, l'option de sélection du papier peint apparaîtra. Vous pouvez également faire glisser la souris de gauche à droite, et l'option de sélection du papier peint apparaîtra.

Personnes

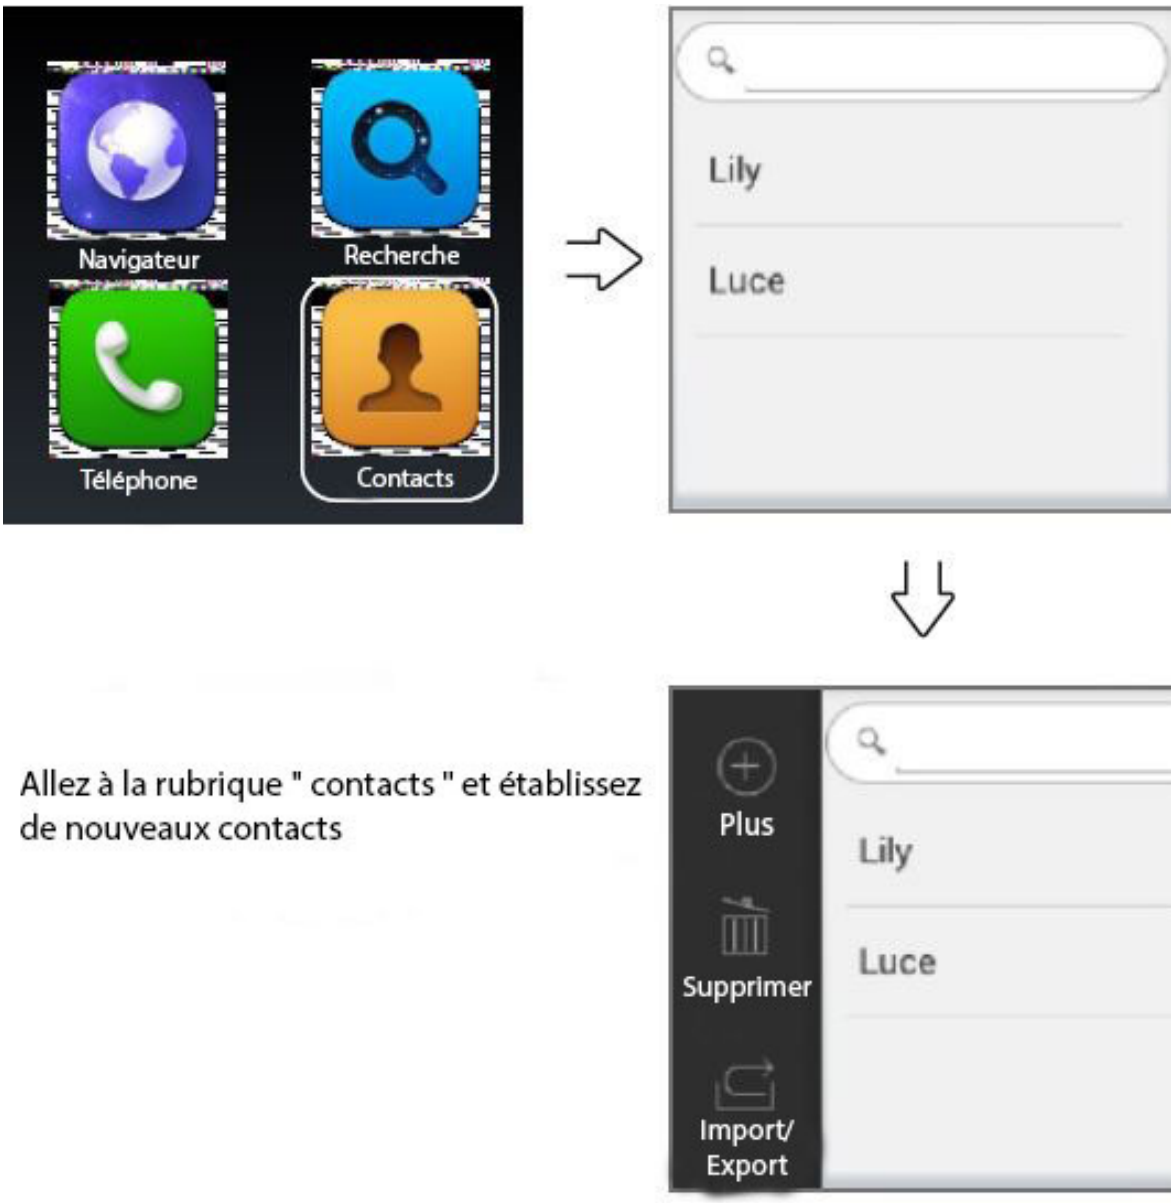

Allez à la rubrique " contacts " et établissez de nouveaux contacts

Tests de fréquence cardiaque en charge



Fréquence cardiaque





Charge d'aspiration magnétique

Chargeur fonctionnant par adsorption douce